

laboratorio de acreditación



entidad mexicana de acreditación a.c.

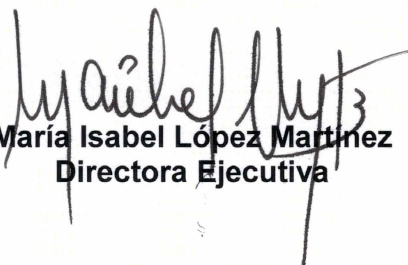
ACREDITA
A
**ELUS SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO
EIRELI ME**

**RUA DENZEIRO 29,
C.P. 03813130, SÃO PAULO, BRASIL.**

Como Laboratorio de Calibración de acuerdo a los Requisitos establecidos en la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005) para las actividades de evaluación de la conformidad en el área:

Óptica*

El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005 por parte de un laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma consistente resultados de ensayos y calibraciones técnicamente válidas. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma ISO/IEC 17025:2005 (sección 4) están escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos" y además son afines a sus requisitos pertinentes."


María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva



**Acreditación No: OP-27
Vigente a partir del 2015-09-23***

*En el alcance establecido en el anexo técnico correspondiente 15LC0178

Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico.

FOR-LAB-011-01

ACREDITACIÓN OP-27

2016-09-26

Revisión: 01

I	Servicio de Calibración o Medición		IV	VI				IX
	II	III		Incertidumbre expandida de medida				
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida	Intervalo o punto de medida	Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	Observaciones
Turbidez	Medidores de Turbidez	Comparación directa com Materiales de Referencia Certificado	(0-1000) NTU	0.008	NTU; FTU; FAU;	0.007	Absoluta	no hay disponibilidad de Ensayos de aptitud - como el banco consultado EMA y EPTIS
Absorbancia Espectral	Colorímetro	Comparación directa com Materiales de Referencia Certificado	(0 a 10) mg/L (Cloro)	0,01	mg/L	0,008	Absoluta	no hay disponibilidad de Ensayos de aptitud - como el banco consultado EMA y EPTIS
Absorbancia Espectral	Colorímetro	Comparación directa com Materiales de Referencia Certificado	(0 a 10) mg/L (Fluor)	0,01	mg/L	0,008	Absoluta	no hay disponibilidad de Ensayos de aptitud - como el banco consultado EMA y EPTIS
Absorbancia Espectral	Colorímetro	Comparación directa com Materiales de Referencia Certificado	(0 a 500) Pt/Co	2	Pt/Co	1.33	Absoluta	no hay disponibilidad de Ensayos de aptitud - como el banco consultado EMA y EPTIS

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

1. Rodrigo Gomes Cordeiro
2. George Gomes Cordeiro